



SZAKMAI VÉLEMÉNY

A Snuza (Mobile baby movement monitor) készüléket az elmúlt 2 hónapban a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centrumában használtuk. A készülék kipróbálásán volt nálunk.

Az eszköz kis méretű. Ennek elsősorban előnyét láttuk, mivel a gyermek testmérete ebből a szempontból indifferens volt. Be és kikapcsolása egyszerű. A riasztás hangereje közepes, nagyobb távolságból (másik kórterem) a riasztási hang bizonytalan.


Az eszköz pelenkához való rögzítése egyszerű, de élénkebb, jelentősebb spontán mozgást produkáló csecsemő esetén a lecsúszás veszélye nagyobb lehet, mint újszülötteknél.

Álrisztást nem észleltünk.

A készülék tisztántartása megoldható.

A riasztás megindulása a légzés kimaradása után nem befolyásolható, az gyárilag beállított. Önmagában ez nem hiba, de talán előny lehetne, ha ez módosítható lenne.

Összességében a készüléket jól használhatónak ítéltük meg.

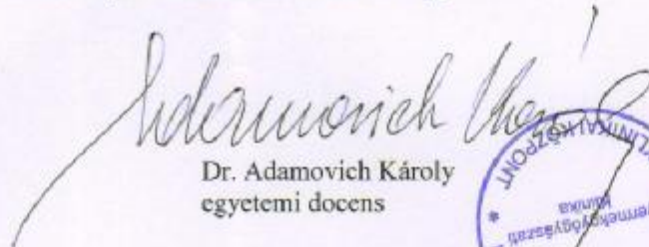

Dr. Adamovich Károly
egyetemi docens



Pécs, 2010. december 21.